



Gebrauchsanweisung für

CO₂ Melder

Inhaltsangabe

- 2 Vorwort & Technische Spezifikationen
- 3 Garantiebedingungen
- 4 Wichtige Sicherheitshinweise
- 7 Inhalt der Verpackung
- 8 Übersicht der Installation
- 9 Installationsanleitung
- 15 Wartung
- 17 Entsorgung und Kennzeichnung

Vorwort

VIELEN DANK, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt **aus unserem Hause** entschieden haben.

Zur Ihrer eigenen Sicherheit und für die korrekte Funktion des Gerätes. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät installieren und benutzen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Gerät nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Gerät verkaufen, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.

Neues Wasser Group übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Personen, Eigentum oder Tieren, die infolge einer Nichtbeachtung der Anweisungen in der Betriebsanleitung direkt oder indirekt entstehen können, besonders hinsichtlich Installation, Betrieb und Bedienung sowie Wartung des Geräts.

Copyright

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Somit sind auch alle darin enthaltene Bilder und Texte als geistliches Eigentum von **Neues Wasser Group** zu betrachten.

Jede Vervielfältigung, Verwendung und / oder Veröffentlichung des Inhaltes in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sind ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung von **Neues Wasser Group** nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichtet zu Schadenersatz. **Neues Wasser Group** behält sich das Recht vor, zusätzliche Ansprüche geltend zu machen.

Garantiebedingungen

Neues Wasser Group gewährt eine 24-monatige Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie bezieht sich auf alle wesentlichen Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Sie erfolgt durch eine Ersatzlieferung eines einwandfreien Gerätes oder durch die kostenlose Reparatur des eingesandten Gerätes, wenn folgende Voraussetzungen gewährleistet sind:

- Das Gerät wurde sachgemäß und laut den Empfehlungen in der Betriebsanleitung behandelt.
- Es wurde weder vom Käufer noch von einem Dritten versucht, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren.
- Es wurden nur original Ersatz-, Ergänzungs-, Zubehör- und Verschleißteile verwendet.
- Bei Vorlage des Kaufbelegs.

Normale Abnutzung von Teilen und Komponenten, optische Veränderungen, zerbrechliche Teile wie Glas oder Plastik, sowie Verschleiß- und Verbrauchsteile sind von der Garantie ausgeschlossen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist.

Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, Fahrlässigkeit, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Die Transportkosten durch ein Speditionsunternehmen sind nicht in der Garantie enthalten. Um diese zu verringern, bewahren Sie bitte die Originalverpackung für den Zeitraum der Garantie auf.

Diese Garantie beschränkt sich auf die Ersatzlieferung und Reparatur nach den vorgenannten Bedingungen. Andere Ansprüche gegen uns, etwa auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist — sind ausgeschlossen. Diese Garantie berührt selbstverständlich nicht die gegenüber dem Händler / Verkäufer bestehenden gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsansprüche.

Sicherheit und Wartung

- Bitte verwenden Sie das Messgerät nicht in einer staubigen oder ätzenden Gasumgebung, um eine kurze Lebensdauer oder Beschädigung an dem Geräts zu vermeiden.
- Wenn das Batteriesymbol auf dem Bildschirm als leer angezeigt wird, laden Sie die Batterie bitte rechtzeitig auf. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, muss die Batterie herausgenommen werden.
- Bitte lagern oder verwenden Sie das Messgerät nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit ebenso nicht bei brennbaren, explosiven und starken elektromagnetischen Feldern. Verwenden Sie zur Pflege des Gehäuses ein weiches Tuch und neutrale Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Schleif- oder Lösungsmittel, um das Gehäuse nicht zu korrodieren und das Messgerät zu beschädigen.

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG – Erstickungsgefahr!

- Das CO₂ Gas ist farblos und weitgehend geruchs- und geschmacksneutral und kann daher von Menschen nicht wahrgenommen werden.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch und Aufbewahrung der CO₂ Gasflaschen könnte Kohlenstoffdioxid entweichen. Bereits bei Konzentrationen von ungefähr 4-5 % in der Luft (normale Atemluft enthält ca. 0,04 % Kohlenstoffdioxid) jedoch führt das Gas zu Schwindel, Benommenheit, Kopfschmerzen, Atemprobleme, Krämpfe, Ohnmacht und Atemstillstand.
Wenn eine Kohlendioxid-Konzentration von über 10 % auftritt, führt dies zu Bewusstlosigkeit in weniger als einer Minute. Ohne unverzügliche Gegenmaßnahmen wird diese Situation zum Tod führen.
- Bitte beachten Sie stets die Hinweise auf dem Etikett und im Sicherheitsblatt der CO₂ Zylinder.
- Wenn Sie den Verdacht haben, dass die CO₂-Konzentration steigt, versuchen Sie nicht einzuatmen, verlassen Sie umgehend den gefährlichen Bereich und lüften Sie den Aufstellort vollständig.
- In Räumen ohne natürliche Be- und Entlüftung ist eine technische Lösung oder ein Gaswarngerät (optional erhältlich) notwendig.

Beispielberechnung Gefährdung durch Druckgasversorgung (CO₂):

Situation: Aufstellungsraum für Druckgasbehälter mit z.B. 20 m² Grundfläche.

Berechnung: Raumgröße: 20 m² x 2,50 m Höhe = 50 m³ Raumvolumen

Druckgasbehälter: 10 kg CO₂: dies entspricht ca. 5 m³ Gasvolumen

Formel: Gaskonzentration = Gasvolumen / Raumvolumen x 100

Umrechnungstabelle der Gasmenge von der CO²-Flasche (Flascheninhalt)

CO ² Gasflasche	in Liter	Gasmenge	Raumvolumen
2 kg	1.000 L	1,00 m ³	34 m ³
6 kg	3.000 L	3,00 m ³	102 m ³
10 kg	5.000 L	5,000 m ³	170 m ³

Allgemeine Sicherheitshinweise zum Umgang mit CO₂ Gasflaschen

- Lesen Sie dazu WARNUNG - Erstickungsgefahr unter wichtigen Sicherheitshinweisen
- Die Kohlendioxidflasche niemals starker Erwärmung (durch direkte Sonneneinstrahlung, offenes Feuer, Heizkörper o.ä.) aussetzen. Ebenso darf die CO₂-Flasche nicht in direkter Nähe zu Brenngas- oder Sauerstoffflaschen gelagert oder benutzt werden.
- Die CO₂-Flasche steht unter Druck. Eine unsachgemäßer Handhabung kann schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen.
- Flasche niemals ohne Druckminderer nutzen, defekte Teile sofort austauschen.
- Vor Korrosion, Beschädigung und unbefugtem Zugriff schützen.
- Verwenden Sie nur ausschließlich natürliche, lebensmittelreine Kohlensäure nach EU Standard E290 für die Herstellung von mineralisiertem Wasser.
- Der CO₂ Zylinder sollte beim Transport, der Aufbewahrung und der Nutzung immer aufrecht stehen.

ACHTUNG – Explosionsgefahr: CO₂ Zylinder sollte nur stehend verwendet werden und gegen Umfallen gesichert werden!

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bitte prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken. Bei einem Transportschaden verwenden Sie das Gerät nicht.
- Halten Sie das Gerät, Zubehörteile und die Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle und Erstickung vorzubeugen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit beschränkten geistigen, physikalischen oder sensorischen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt werden, außer sie werden aufmerksam beaufsichtigt und eingewiesen.
- Das Gerät nur in den geschlossenen Räumen verwenden und vor Regen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen schützen.
- Die Installation und der Service sollte von einem Fachmann vorgenommen werden. Fehlerhafte Installation kann zum Ausschluss der Garantie führen.
- Bitte entsorgen Sie das Gerät, wenn es defekt ist oder keine Nutzung mehr geplant ist, entsprechend der Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie WEEE. Für Rückfragen stehen Ihnen die lokalen Behörden, die für die Entsorgung zuständig sind, zur Verfügung.

Technische Spezifikationen

Parameter	Indikator
Messbereich für die Kohlendioxidkonzentration	0 - 9999 PPM
Auflösungsverhältnis der Kohlendioxidkonzentration	1 PPM
Genauigkeit	± 10% der Messwerte von 40 PPM
Arbeitstemperaturbereich	-10°C bis +60 °C / 14 bis 140 °F
Arbeitsluftfeuchtigkeitsbereich	0 bis 99 %RH
Lagertemperaturbereich	-40 bis +80 °C / -40 bis 176 °F
Temperaturmessbereich	-20 bis +60 °C / -4 bis 140 °F
Temperatur Messgenauigkeit	± 1 °C
Luftfeuchtigkeitsmessbereich	0 bis 100 %RH
Luftfeuchtigkeitsmessgenauigkeit	± 3 %RH
Energieversorgung	3.7V 18650 Akku (im Lieferumfang) Oder über einen externen 5V USB Netzanschluss
Netzspannung	180 bis 300 mA
Batterielebensdauer	2200 mAh bei Arbeitsdauer >9h täglich
Batterieladedauer	ca. 3 Stunden
Aufzeichnungsdatensätze	999 Datensätze
Gewicht	173g
Größe B x H x T	140 x 134 x 33 mm

Das Anwendungsgebiet des Kohlendioxiddetektors

1. Im öffentlichen Räumen

In stark besuchten Orten wie Besprechungsräumen, Klassenzimmer, Ausstellungshallen, Krankenhäuser, Kaufhäuser, Bars, Hotel, Flughafen, Eisenbahnhöfen und Unterhaltungshallen usw. Der Kohlendioxiddetektor kann zur Belüftungskontrolle und zur Überwachung der Umgebungsluftqualität verwendet werden.

2. In der Landwirtschaft

Der Kohlendioxid kann die Produktion, Wachstum und die Photosynthese der landwirtschaftlicher Kulturpflanzen verbessert werden. Daher ist diese Art von Luftdünger in der Landwirtschaft weit verbreitet. Der Kohlendioxiddetektor kann zur Einstellung der richtigen Konzentration an Kohlendioxid beitragen.


3. bei der Tierhaltung

Die Luftqualität ist wichtig für ein gesundes Wachstum der Tiere. Wenn die Kohlendioxidkonzentration hoch und keine Versorgung mit Frischluft vorhanden ist, können die Tiere krank werden oder eine Epidemie Ausbruch kommen. Eine Installation eines Kohlendioxiddetektors kann das verhindern.

4. In der Industrie

Der Kohlendioxiddetektor wird beispielsweise bei der Abwasserbehandlung, in Fabrikgebäude, Werkstätten, im Reinigungsraum oder zur Produktionssicherheit eingesetzt. Der Kohlendioxiddetektor wird im Allgemeinen in der Metallverarbeitung, bei der Herstellung von Papierzellstoff und Papier, bei der Reinigungs- und Lösungsmittelextraktion sowie bei der Reinigung bei niedrigerer Temperatur und bei der Kohlendioxid-relevanten Herstellungsverfahren eingesetzt.

Produktübersicht

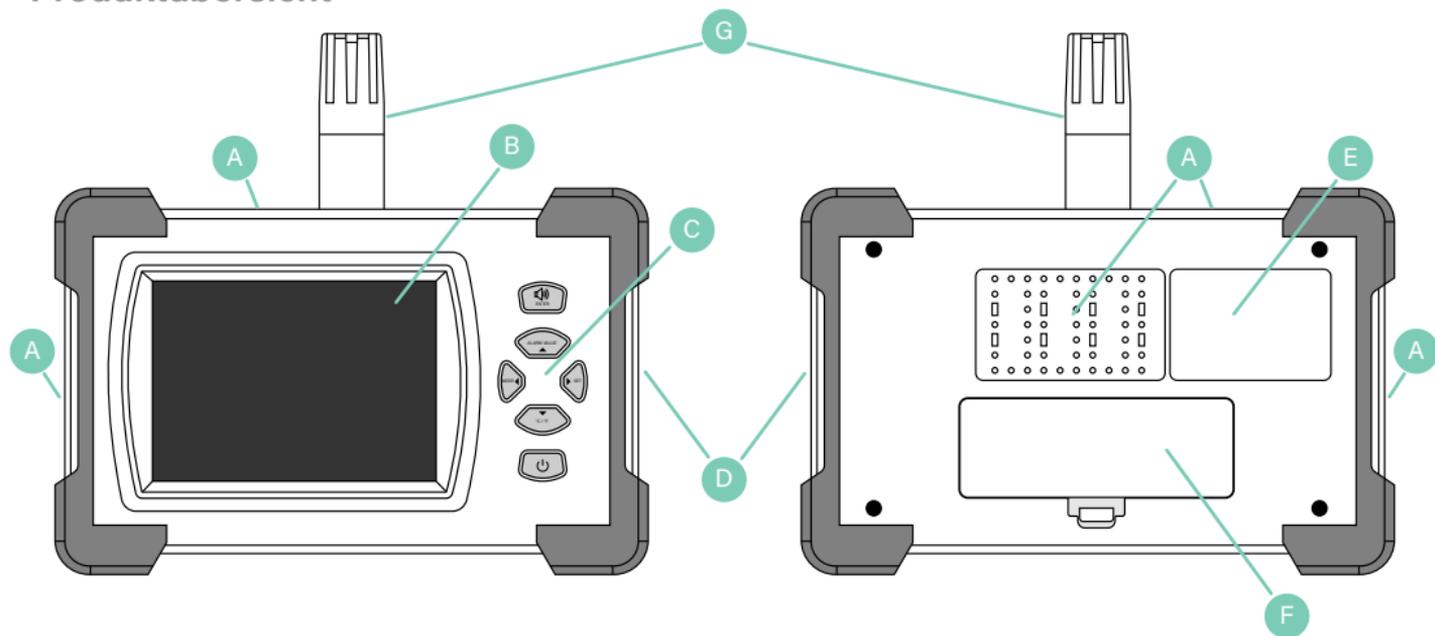


- A. Belüftungsöffnungen
- B. Bildschirm
- C. Bedienknöpfe
- D. USB Anschluss

- E. Seriennummer Aufkleber
- F. Batteriefach
- G. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor



Achtung: Die Belüftungsöffnungen dürfen im Testmodus auf keinen Fall blockiert oder abgedeckt werden.

Tastenfunktionen

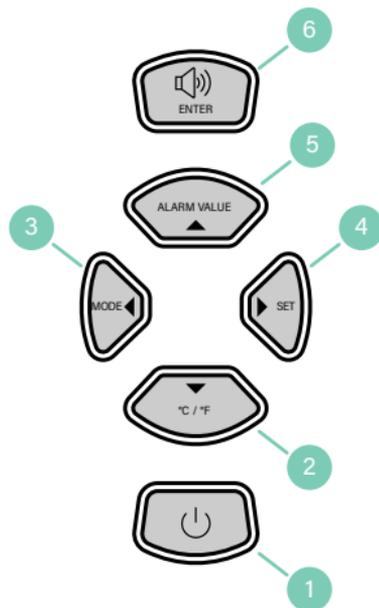


1. Ein / Aus
2. Testmodus: Temperatureinheiten einstellen
Einstellmodus: im Menü nach unten bewegen
3. Messmodus: Wechseln Sie die Schnittstelle für historische Tendenzen
Einstellmodus: Daten verschieben oder reduzieren
4. Testmodus: Aufnahmen oder Einstellen
Einstellmodus: Zum Verschieben oder Hinzufügen von Daten
5. Messmodus: Alarmeinstellung
Einstellmodus: im Menü nach oben bewegen
6. Messmodus: Alarmtöne ein- oder ausschalten
Einstellmodus: Daten verschieben oder reduzieren

Bildschirmanzeige


Testmodus



Entwicklungsverlauf

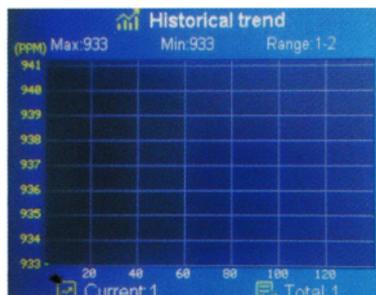

Alarmeinstellung

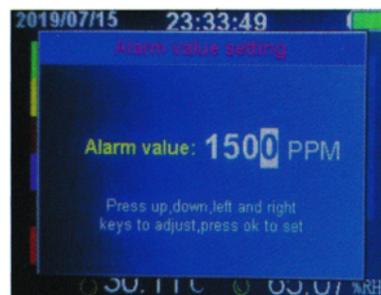

Aufzeichnungen

< Records >

NO	001	002
Date	2019/07/15	2019/07/15
Time	23:36:04	23:36:19
CO ₂	930	933
Temp	30.00	30.03
RH	63.34	64.10

Einstellungen


< Setting >

Backlight:	25%
Data Clear:	No
Time Rev.:	No
Auto shutdown:	OFF
Record interval:	Enter
Calibration:	Enter
Language:	English
Reset:	No

Kalibrierung



- **Betriebsbeschreibung:** (Achtung! Betreiben oder kalibrieren Sie das Gerät nicht nach Belieben, um Fehler bei der Datenerkennung oder Ungenauigkeit zu vermeiden.)
- **Ein- oder Ausschalten**
Drücken Sie kurz die Taste  um das Gerät ein- oder auszuschalten.

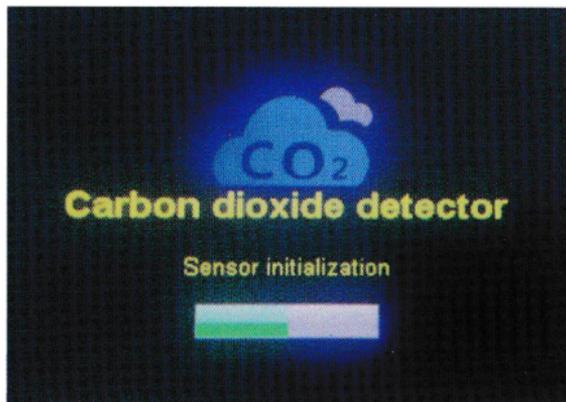

- Umschalten der Tendenzdiagrammschnittstelle

Drücken Sie einmal die Taste  um den Entwicklungsverlauf ein- oder auszublenden.




- **Temperatureinheit umstellen**

Drücken Sie die Taste  um zwischen °C und °F zu wechseln.





- **Alarmtöne ein- und ausschalten**

Drücken Sie die Taste  um den Alarm ein- und auszuschalten.

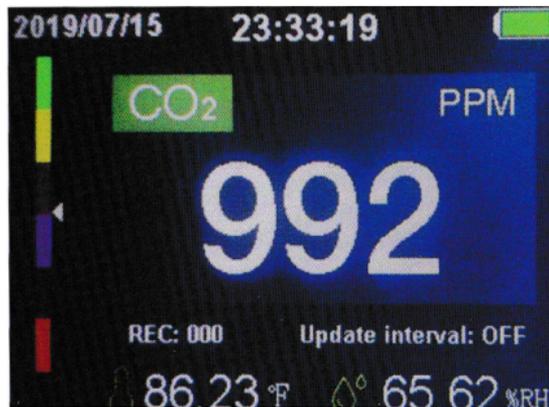

Alarmeinstellungen

Drücken Sie im Messzustand die Taste  und die Alarmeinstellung wird angezeigt. Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um den Wert zu verschieben. Drücken Sie die Auf- oder Abtaste, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern. Sie können die Alarmeinstellung speichern oder beenden.

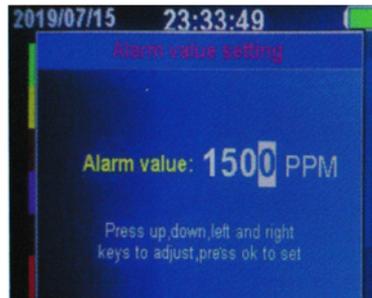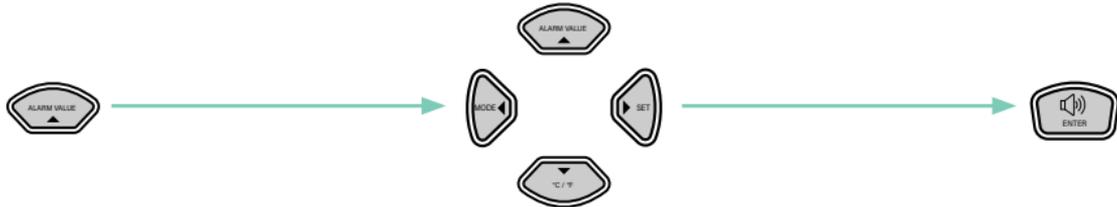

• Datenmessungsintervall

Drücken Sie zweimal die Taste  um die Einstellungen aufzurufen. Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um den Wert einzugeben. Drücken Sie die Auf- oder Abtaste, um die Parameter einzustellen. Drücken Sie die Taste  um zu bestimmen und zurückzukehren.




历史记录

序号	001	002
日期	2019/07/06	2019/07/06
时间	22:24:14	22:22:14
CO2	1382	1305
温度	84.60	84.96
湿度	61.94	63.67

< Setting >

Backlight:	25%
Data Clear:	No
Time Rev :	No
Auto shutdown:	OFF
Record interval:	Enter
Calibration:	Enter
Language:	English
Reset:	No



< Setting >

Update interval

Off
1min
5min
10min
15min
30min
1hour
2hour

Aut. Rec.

< Setting >


Backlight:	25%
Data Clear:	No
Time Rev :	No
Auto shutdown:	15 min
Record interval:	Enter
Calibration:	Enter
Language:	English
Reset:	No

< Setting >

Backlight:	25%
Data Clear:	No
Time Rev :	No
Auto shutdown:	OFF
Record interval:	Enter
Calibration:	Enter
Language:	English
Reset:	No

- **Entwicklungsintervall**

Drücken Sie einmal die Taste  und drücken Sie die Taste  um zu den Aufzeichnungen <RECORDS> zu gelangen. Mit der linken oder rechten Taste wählen die Messparameter. Mit den Auf- oder Abtasten wächseln Sie zwischen den Aufzeichnungsseiten.

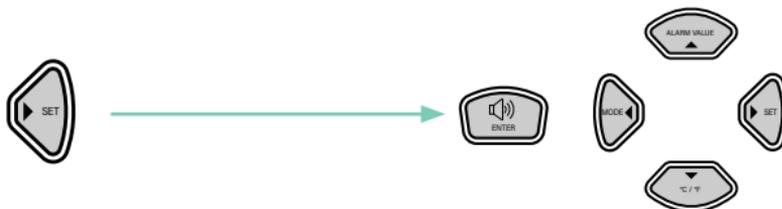

<Records>

NO	001	002
Date	2019/07/15	2019/07/15
Time	23:36:04	23:35:19
CO2	930	933
Temp	30.00	30.03
RH	63.34	64.10




<Records>

NO	001	002
Date	2019/07/15	2019/07/15
Time	23:36:04	23:35:19
CO2	930	933
Temp	30.00	30.03
RH	63.34	64.10

Current: 00  Total: 002




- **Parametereinstellungen**

Drücken Sie zweimal die Taste  und drücken Sie die Taste  um zu den Einstellungen <SETTINGS> zu gelangen. Die entsprechenden Parameter wählen Sie mit den Auf- oder Abtasten. Die ausgewählte option erscheint in heller Hintergrundfarbe. Mit der linken oder rechten Taste können Sie die Parameter ändern.

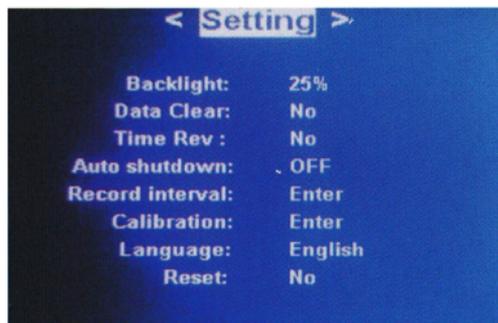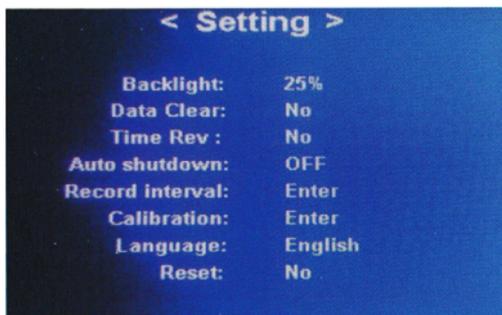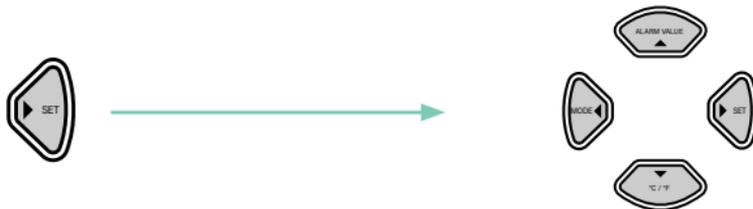





- **Hintergrundfarbe**

Mit der linken oder rechten Taste können Sie die Helligkeit des Bildschirms in folgenden Stufen ändern: 25% - 50% - 75% - 100%

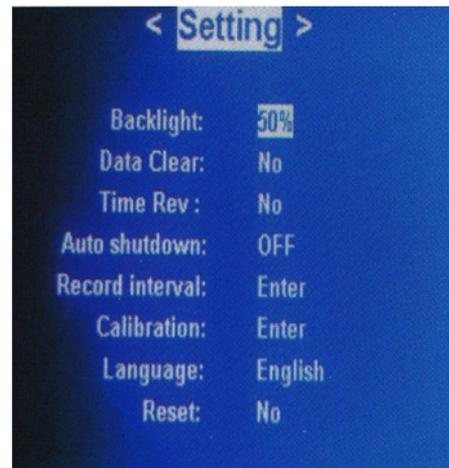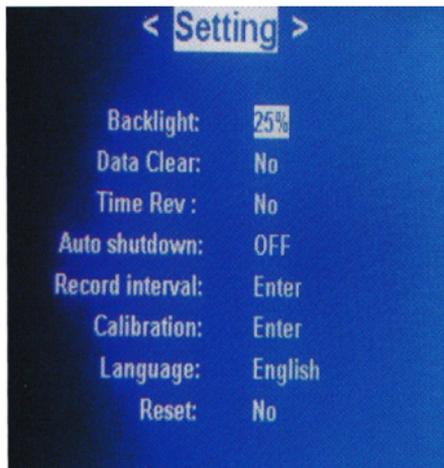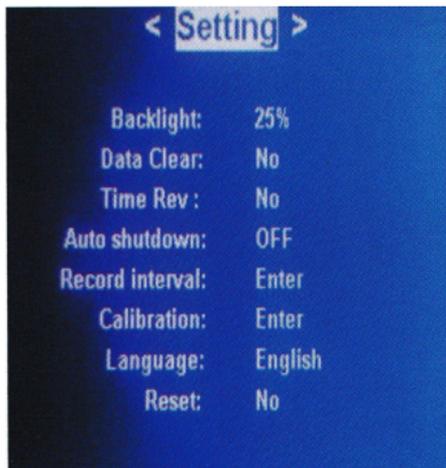






- **Daten löschen**

Mit der linken oder rechten Taste können Sie zum Datenfreigabemenü wechseln. Drücken Sie die linke Taste erneut, um die Daten zu löschen und verwenden Sie die rechte Taste, um die Eingabe zu bestätigen.

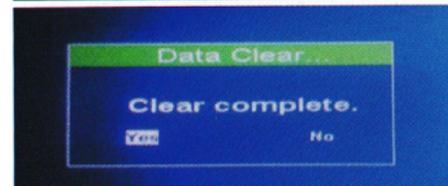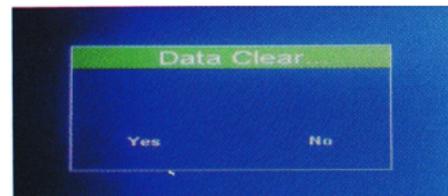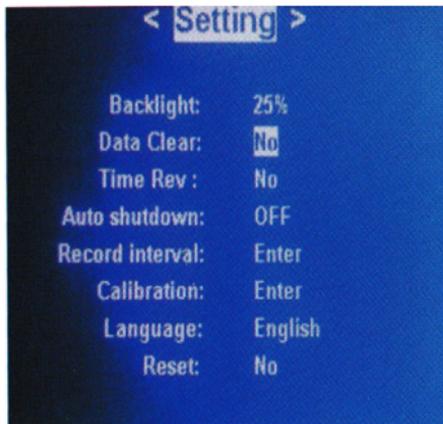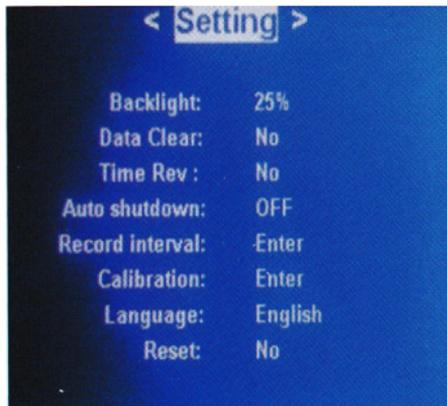

Datum- und Uhrzeiteinstellen

Benutzen Sie die linke und rechte Taste um zu den Datum- und Uhrzeiteinstellungen <TIME REV> zu gelangen. Drücken Sie erneut die linke oder rechte Taste um Datum und Uhrzeit einzustellen. Mit der Auf- und Abtaste können Sie die Parameter ändern. Drücken Sie die Taste  um wieder zurück zum Hauptmenü zu gelangen.

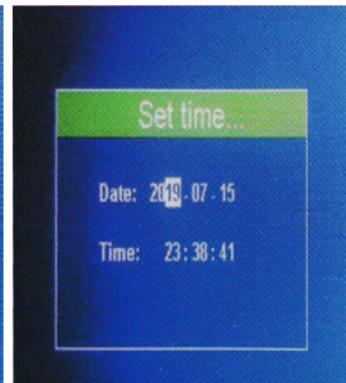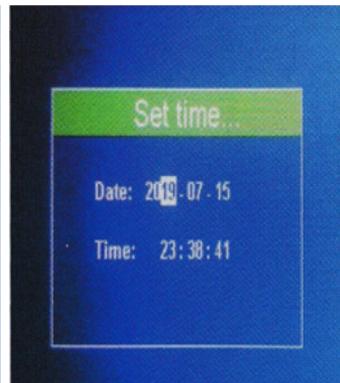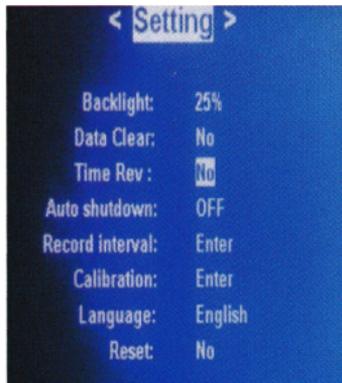
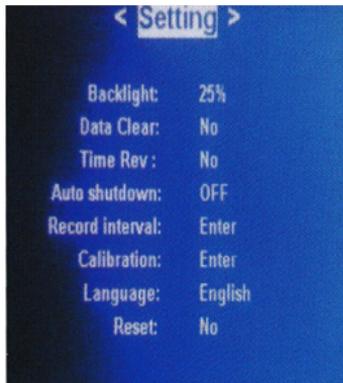
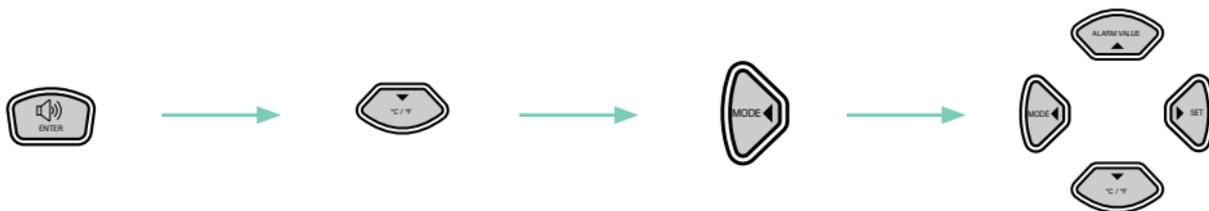


- **Automatisches Abschalten**

Die automatische Abschaltung kann in folgenden Schritten ausgewählt werden:




15min / 30min / 45min / 1h / 2h / 4h / 8h

Oder deaktivieren Sie die automatische Abschaltfunktion indem Sie OFF auswählen.

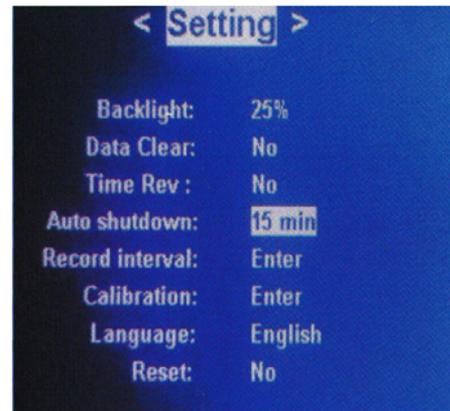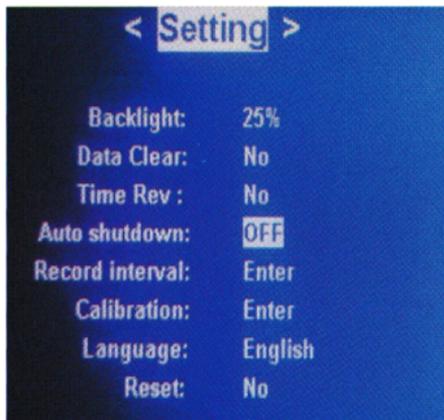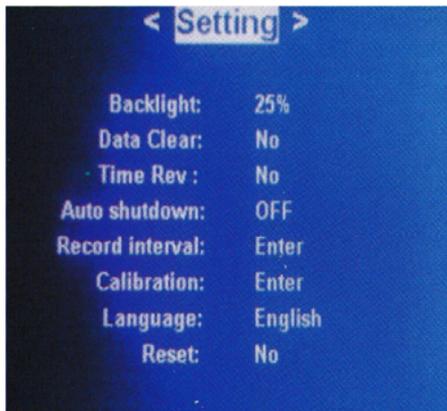

Aufzeichnungsintervall




Benutzen Sie die linke und rechte Taste um zu den Aufzeichnungsintervalleinstellungen RECORD INTERVAL zu gelangen. Benutzen Sie die Auf- oder Abtaste um ein Intervall auszuwählen. Drücken Sie die Taste  um die Auswahl fertig zustellen. Drücken Sie  um das Menü wieder zu verlassen.

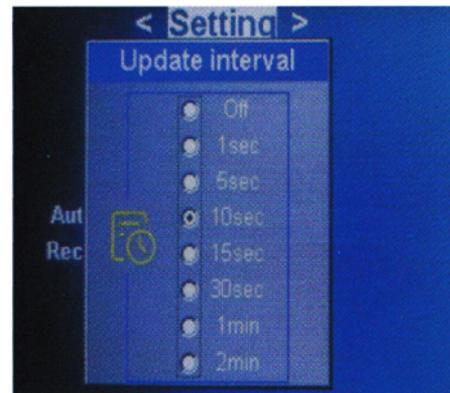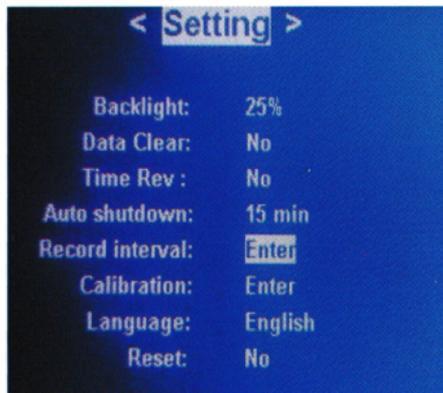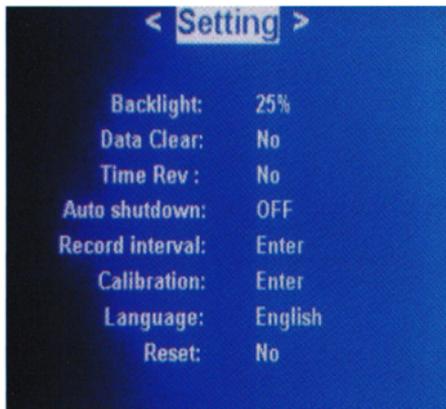

• Kalibrierung




Benutzen Sie die linke und rechte Taste um zu den Kalibrierungseinstellungen CALIBRATION aufzurufen und geben Sie 600 Sekunden für den Countdown ein. Drücken Sie die Taste  um die Kalibrierung zu beenden oder abzubreche.

Hinweis: Die Ausführung des Schritts sollte in einer Umgebung mit 400 PM/min erfolgen, die sich nicht innerhalb von 600 Sekunden ändert.

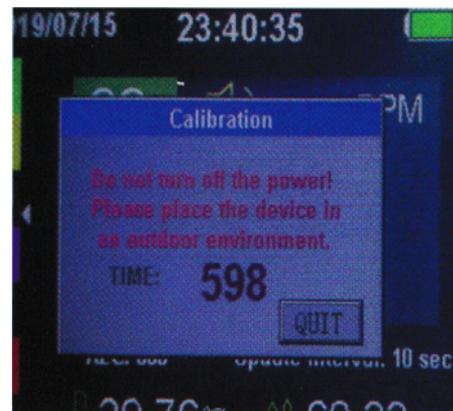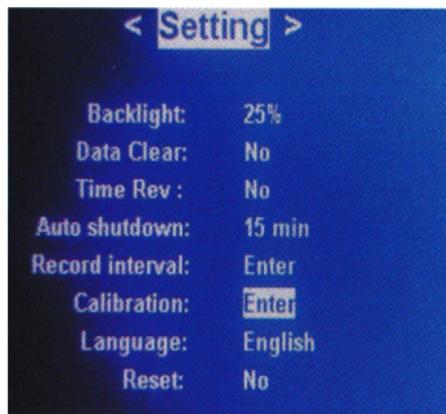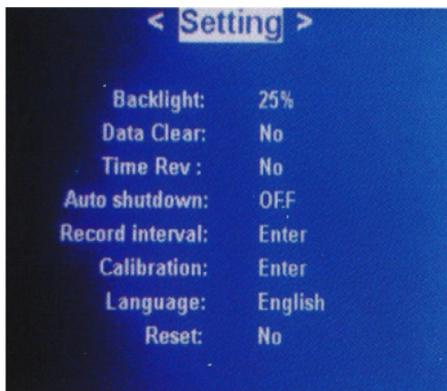

• Spracheinstellung




Benutzen Sie die linke oder rechte Taste um zwischen Englisch und Chinesisch auszuwählen.

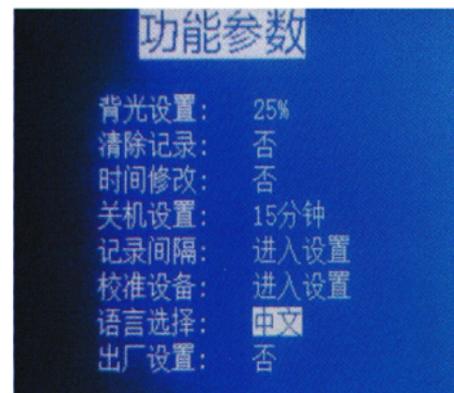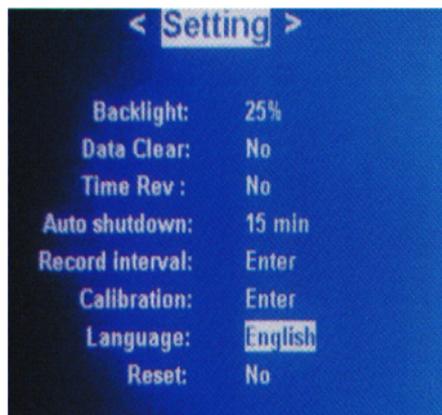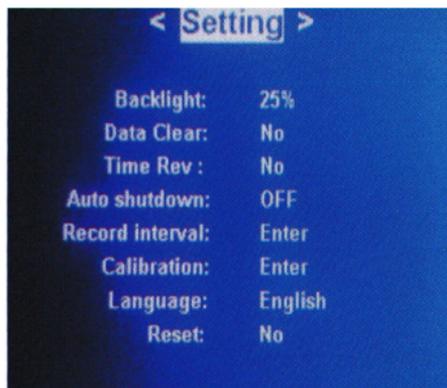

- **Auf Werkseinstellung zurücksetzen**


Benutzen Sie die linke und rechte Taste um das Gerät auf die Werkseinstellung RESET zurückzusetzen. Drücken Sie erneut die linke Taste um die Auswahl zu bestätigen und die rechte Taste um die Auswahl abzubrechen.

- Bei der zurücksetzung auf Werkseinstellung werden alle Einstellungen und Daten gelöscht.

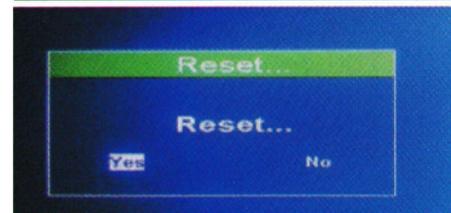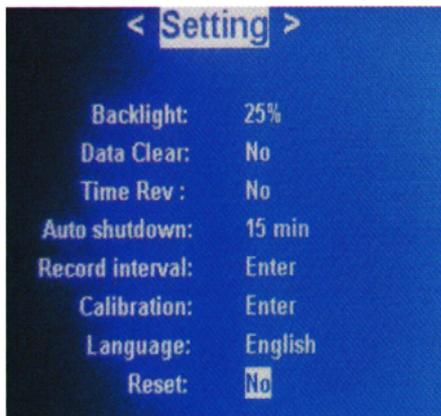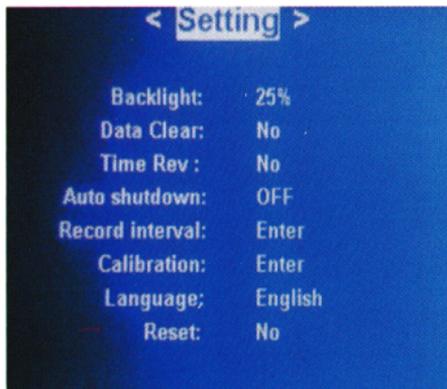

Kohlenstoffdioxid Konzentrationsniveau

400 - 450 PPM	frische, natürliche Umgebungsluft, gewöhnliche Außenluft
450 - 700 PPM	hohe Raumluftqualität mit guter Belüftung
700 - 1000 PPM	mittlere Raumluftqualität mit mangelhafter Belüftung
1000 - 2000 PPM	schlechte Raumluft, Müdigkeit und Schläfrigkeit können einsetzen
2000 - 5000 PPM	alte und stickige Luft. Es können folgende körperliche Symptome auftreten: Schläfrigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörung, Herzrhythmusstörungen und leichte Übelkeit.
über 5000 PPM	Akute Lebensgefahr! Kann zu schwerer Anoxie, irreparablen Hirnschäden verursachen, so wie zu Bewusstlosigkeit, Koma und Tod führen.

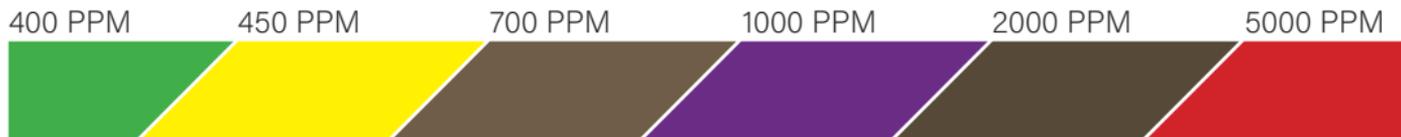

Häufig gestellte Fragen

1. Die Kohlendioxidkonzentrationsdaten in der Luft sind nicht genau.

Möglichkeit 1: Der Konzentrationsgehalt der Umgebung ist nicht stabil. Stellen Sie das Gerät zum Zeitpunkt der Messung für einen bestimmten Zeitraum an derselben Stelle auf.

Möglichkeit 2: Am Probenahmefenster des Kohlendioxidsensors befinden sich Verunreinigungen oder Schmutz. Das Luftstrom-Belüftungsfenster ist blockiert.

Möglichkeit 3: Der Kohlendioxidsensor weist eine Abweichung auf. Das Gerät muss erneut kalibriert werden.

2. Es wird falsche Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt.

Möglichkeit 1: Am Probenahmefenster des Temperatur- und Feuchtigkeitssensors befinden sich Verunreinigungen oder Schmutz.

Möglichkeit 2: Das Lüftungsfenster wurde durch etwas blockiert.

3. Datum und Uhrzeit sind nicht korrekt

Möglichkeit 1: Wird verursacht durch zu niedrigen Batteriestand.

4. Das Gerät lässt sich nicht einschalten

Möglichkeit 1: Der Akku hat keinen Strom oder ist beschädigt. Verbinden Sie das Gerät mit dem USB-Kabel und der Stromversorgung. Wenn der Ladevorgang startet ohne weitere Fehlermeldung, bedeutet es das der Akku leer war. Zeigt der Bildschirm allerdings ein OK so ist die Batterie wahrscheinlich beschädigt.

Möglichkeit 2: Batterie +/- Polarität ist umgekehrt montiert. Bitte achten Sie darauf, dass der nicht hervorstehende Kontakt an einem Ende der Batterie die Polarität „-“ haben muss und dass der hervorstehende Kontakt an einem Ende die Polarität „+“ haben muss.

Neues Wasser Group
Zeppelinstraße 4
89604 Allmendingen
+49 7391 777 65 22
info@neueswasser.de
www.neueswasser.de